
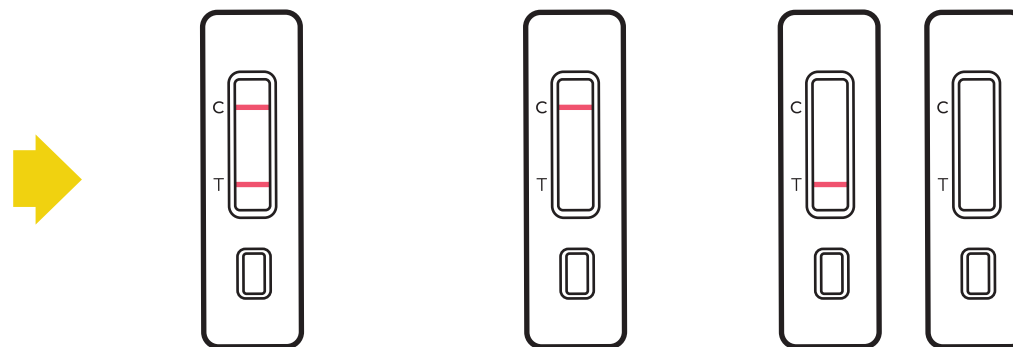


# Dispositivo de prueba rápida Antígeno Urinario de Legionella

COD: LEG-U23

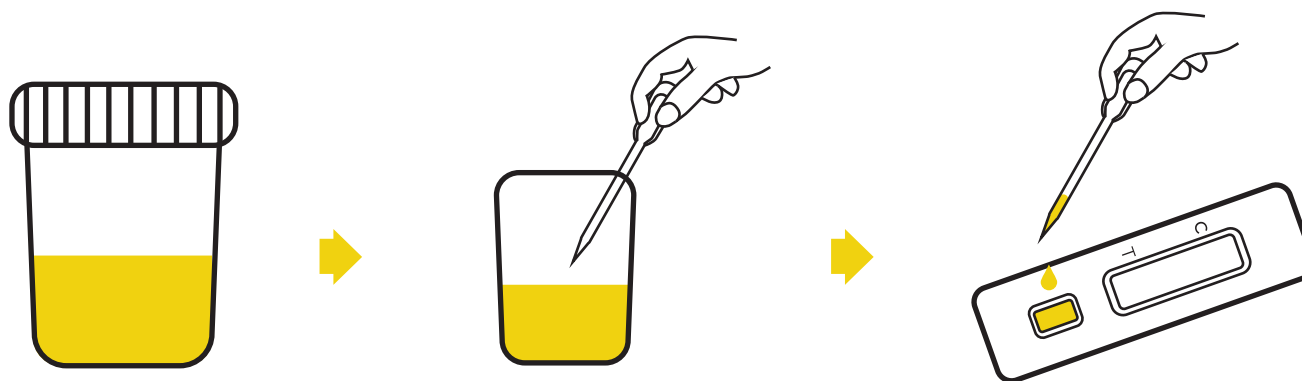

positivo

negativo

inválido